

Eltville, 15.07.2022

Begleit-Information zum Service-Pack 22.3 15.07.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie das Service-Pack **22.3 15.07.2022** für Ihre Praxissoftware x.isynet | x.vianova. Informieren Sie sich bitte im Folgenden über den Inhalt des Service-Packs und lesen Sie die Installationshinweise aufmerksam durch.

Inhalt des Service-Packs

Für Detailinformationen klicken Sie bitte auf die gewünschte Überschrift.

- [Scheinneuanlage bzw. -aufruf durch Einlesen der Chipkarte](#)

Das Einlesen einer eGK, bei korrekt eingerichteter TI, und die anschließende Scheinneuanlage ist möglich.

- [KBV: Nachlieferung der EBM-Stammdateien für Q3/2022](#)

Die aktualisierte EBM-Stammdatei der KBV sowie die EBM-Stammdateien der KV Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Westfalen-Lippe, Nordrhein, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayerns, Berlin, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen sind enthalten.

- [KIM: Einrichten des Zertifikats bei der Registrierung von E-Mail-Adressen schlägt fehl](#)

Wollen Sie eine neue KIM-E-Mail-Adresse registrieren, spielen Sie bitte zuvor dieses Service-Pack ein.

Ist es bei Ihnen bereits zu einem Fehler gekommen, spielen Sie dieses Service-Pack ein und starten Sie die Registrierung gemäß der unten beschriebenen Anleitung neu.

- [eAU: Standardabsender nicht notwendig](#)

Es wurden Anpassungen vorgenommen, sodass es nicht mehr notwendig ist, einen Standardabsender für die eAU in der KIM-Postfachverwaltung anzulegen, um die eAU nutzen zu können. Für die Verwendung der eAU muss dem Mandanten lediglich eine KIM-E-Mail-Adresse zugeordnet werden.

- [eAU: Manueller Abruf der Empfangsbestätigungen fehlgeschlagen](#)

Vereinzelte Fehler beim Abruf von Empfangsbestätigungen und Fehlernachrichten, wenn Ordner nicht vorhanden waren, wurden korrigiert.

- [x.webtermin: Terminbestätigung im x.comcenter](#)

Wird der Platzhalter "Terminart-Bestätigungstext" im Bestätigungs-E-Mail-Text hinzugefügt, für die Terminart aber keine Daten hinterlegt, können Termine dennoch im x.comcenter bestätigt oder abgelehnt werden.

- [eNachricht via KIM: Versand mit geschützten Anlagen](#)

eNachrichten können auch mit geschützten Anlagen als versandbereit gespeichert und versendet werden.

- [eArztbrief: Manueller Abruf bei Benutzer-Mandant-Zuordnung](#)
Der manuelle Abruf von eArztbriefen funktioniert auch unter Einsatz der Benutzer-Mandant-Zuordnung vollständig.
- [Vorsorge: Korrekte Übernahme des Datums der vorangegangenen Untersuchung](#)
Das Datum der vorangegangenen Untersuchung wird bei der Datenübernahme aus vorhergehenden Dokumentationen korrekt angeboten.

Installation des Service-Packs

Installationsvoraussetzung Version **22.3.60**

Versionsbezeichnung nach der Installation Version **22.3.62**



Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, eine tägliche Datensicherung durchzuführen. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie im Falle eines Defektes ohne größeren Verlust auf Ihre Praxisdaten zurückgreifen können.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren medatixx-Servicepartner.

Freundliche Grüße

Ihr Team der medatixx

Detailinformationen

Scheinneuanlage bzw. -aufruf durch Einlesen der Chipkarte

Situation Unter Umständen wird beim Einlesen der eGK die Übersicht der Abrechnungsscheine nicht geöffnet oder die eGK-Daten werden nicht gelesen.

Lösung Das Einlesen einer eGK, bei korrekt eingerichteter TI, und die anschließende Scheinneuanlage ist wieder fehlerfrei möglich.

Sollte eine eGK laut VSDM-Abgleich ungültig oder defekt sein, erscheint eine entsprechende Meldung.

KBV: Nachlieferung der EMB-Stammdateien für Q3/2022

Situation Die aktualisierte EBM-Stammdatei der KBV sowie die EBM-Stammdateien der KV Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Westfalen-Lippe, Nordrhein, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayerns, Berlin, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen standen bisher nicht zur Verfügung.

Lösung Spielen Sie das Service-Pack 22.3 5.07.2022 ein, damit die aktualisierten EBM-Stammdateien bei der Abrechnung berücksichtigt werden können.

KIM: Einrichten des Zertifikats bei der Registrierung von E-Mail-Adressen schlägt fehl

Situation Bei der Registrierung kann es mit dem Feature-Update 22.3 sowie dem Quartalsupdate 22.3 aufgrund falscher Datenbankeinträge dazu kommen, dass das empfangene Zertifikat nicht in das Clientmodul hochgeladen wird:




Lösung Spielen Sie bitte zuerst das vorliegende Service-Pack ein.

Bei oben genanntem Fehlverhalten **löschen** Sie zunächst die bereits angelegte E-Mail-Adresse, bei deren Registrierung es zu obigem Fehler kam, über das Papierkorbsymbol in der KIM Postfachverwaltung (Direktbefehl [KIMVW](#) oder über das Menü [System | Kommunikation | KIM-Postfächer verwalten](#)). Die E-Mail-Adresse erkennen Sie anhand des gelben Symbols unter der Spalte „Status“.


Löschen Sie keinesfalls E-Mail-Adressen, deren Status mit einem grünen Haken angezeigt wird.



Anschließend starten Sie die Registrierung der KIM-E-Mail-Adresse neu.

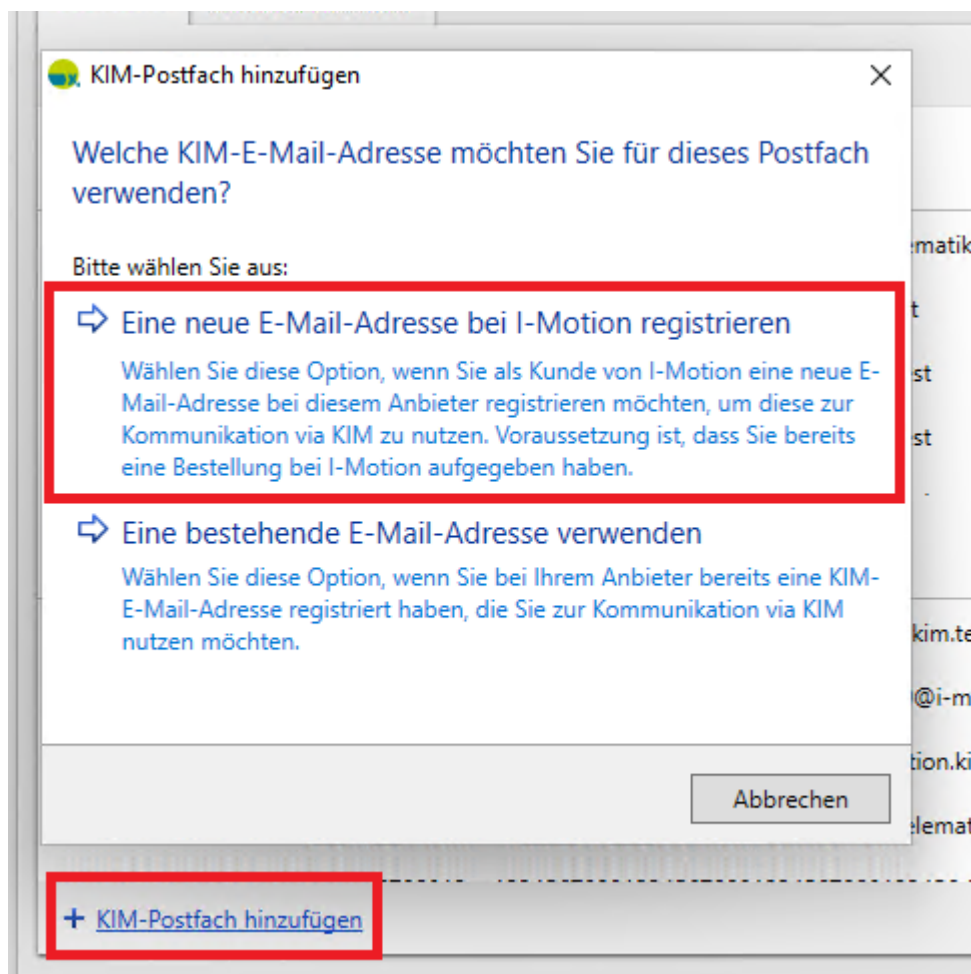

Nach der Eingabe der Wunsch-E-Mail-Adresse erhalten Sie einen Hinweis, dass die Adresse bereits vergeben ist. Mit einem weiteren Klick auf „E-Mail-Adresse registrieren“ wird diese automatisch bei I-Motion deregistriert.

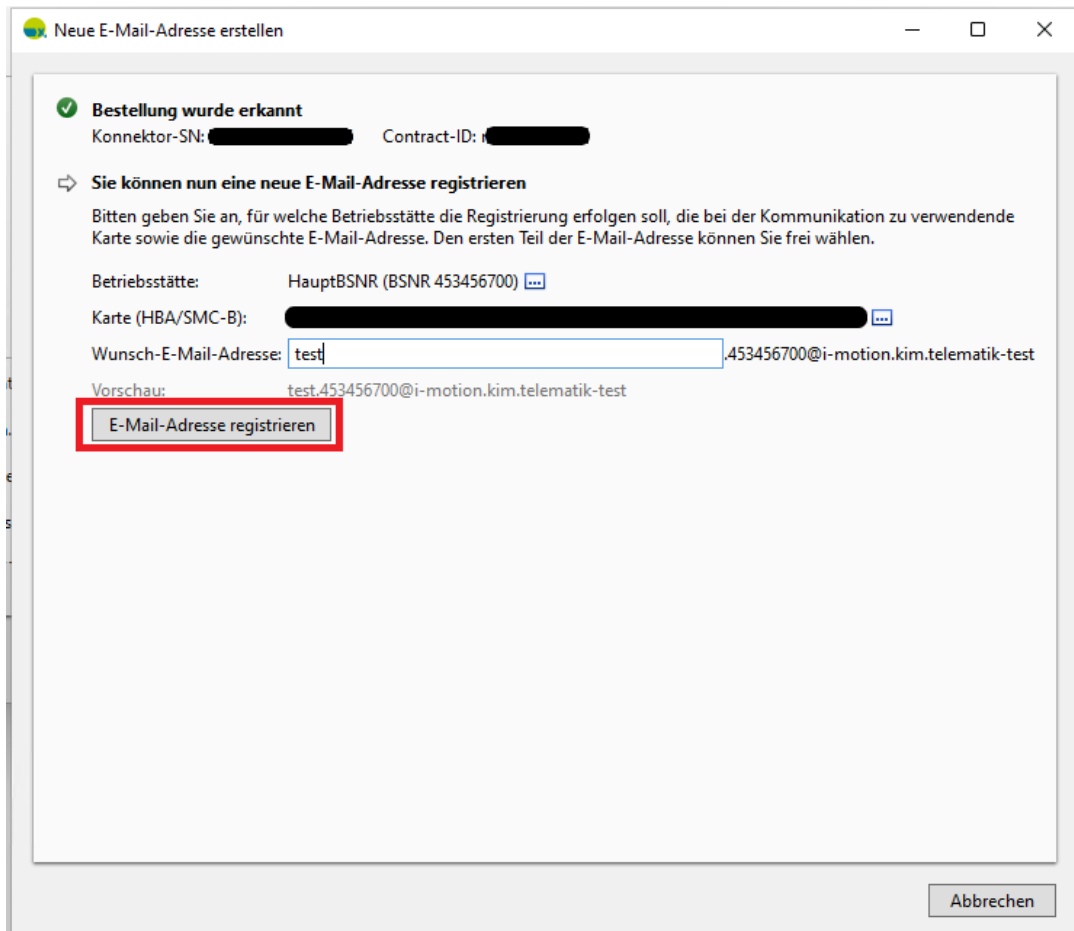

Neue E-Mail-Adresse erstellen

✓ **Bestellung wurde erkannt**
Konnektor-SN: [REDACTED] Contract-ID: [REDACTED]

⇒ **Sie können nun eine neue E-Mail-Adresse registrieren**
Bitte geben Sie an, für welche Betriebsstätte die Registrierung erfolgen soll, die bei der Kommunikation zu verwendende Karte sowie die gewünschte E-Mail-Adresse. Den ersten Teil der E-Mail-Adresse können Sie frei wählen.

Betriebsstätte: HauptBSNR (BSNR 453456700) [REDACTED]

Karte (HBA/SMC-B): [REDACTED]

Wunsch-E-Mail-Adresse: test [REDACTED].453456700@i-motion.kim.telematik-test

Vorschau: test.453456700@i-motion.kim.telematik-test

E-Mail-Adresse registrieren

Abbrechen

Mit einem dritten Klick auf dieselbe Schaltfläche können Sie nun die Registrierung abschließen.

eAU: Standardabsender nicht notwendig

Situation Wird kein Standard-Absender in der KIM-Postfachverwaltung hinterlegt, können mit dem Feature-Update 22.3/ sowie dem Quartalsupdate 22.3 keine eAUs versendet werden.

Lösung Die Zuordnung eines Standard-Absender ist nicht mehr notwendig, da vor dem Versand geprüft wird, ob dem Mandanten eine KIM-E-Mail-Adresse zugeordnet ist.

eAU: Manueller Abruf der Empfangsbestätigungen fehlgeschlagen

Situation Bei Versand von eAUs mit einer neuen KIM-E-Mail-Adressen wird seit dem Quartalsupdate 22.3 teilweise kein Ordner für die Zuordnung von Empfangsbestätigungen und Fehlernachrichten angelegt.

Lösung Die Ordner werden mit dem Service-Pack angelegt.

x.webtermin: Terminbestätigung im x.comcenter

Situation Wird der Platzhalter "Terminart-Bestätigungstext" im Bestätigungs-E-Mail-Text hinzugefügt, für die Terminart aber keine Daten hinterlegt, können seit dem Quartalsupdate 22.3 Termine im x.comcenter teilweise nicht bestätigt oder abgelehnt werden.

Lösung Diese Termine können sowohl bestätigt wie auch abgelehnt werden.

eNachricht via KIM: Versand mit geschützten Anlagen

Situation Im Rahmen der eNachricht kann es seit dem Quartalsupdate 22.3 beim Speichern versandbereiter Nachrichten und Anlagen von insbesondere geschützten Dokumenten zu Fehlern kommen.

Lösung Versandbereite Nachrichten mit geschützten Anlagen werden nun korrekt gespeichert und gesendet.

eArztbrief: Manueller Abruf bei Benutzer-Mandant-Zuordnung

Situation Beim manuellen Abruf von eArztbriefen kommt es unter Verwendung der Benutzer-Mandant-Zuordnung mit dem Feature-Update 22.3 sowie dem Quartalsupdate 22.3 vereinzelt zu einer Fehlermeldung.

Lösung Es werden zukünftig nur die Nachrichten von Postfächern abgerufen, auf die die Mandanten Zugriff haben, die dem Benutzer zugeordnet sind.

Vorsorge: Korrekte Übernahme des Datums der vorangegangenen Untersuchung

Situation Bei der Übernahme von Daten aus vorangegangener Vorsorgeuntersuchung, wird das Datum zum Teil nicht im richtigen Format angezeigt.

Lösung Das Datum wird im korrekten Format angeboten.